

PARECER DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS


PREGÃO 173/2022

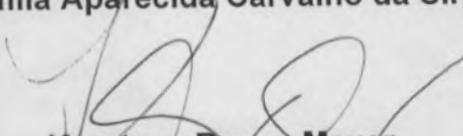
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

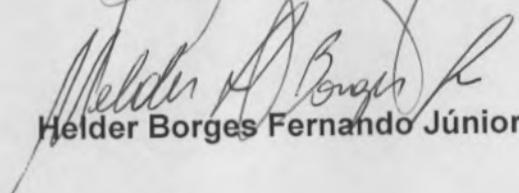
Lote	Item	Resultado	Fornecedor	Avaliação
1	1,66	Mesmo com catálogo, não foi possível verificar se é cabo oco, solicitar esclarecimento.	Suprema dental	Aberto
1	146,149	Mesmo com catálogo, não fala qual material é fabricado, solicitar esclarecimento.	Suprema dental	Aberto
1	2,18,19,20,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,46,47,60,61,62,147,148,150	Aprovado	Suprema dental	Aprovado
1	49	conforme envio Do catálogo não consta se possui 40 farpas flexíveis, cabo cccord. Solicitar esclarecimento.	Suprema dental	aberto
1	3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,27,42,44,51,52,53,54,55,56,57	Aprovado	Athena	Aprovado
1	9,28,50	Aprovado	Excellence	Aprovado
1	67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,145	Empresa apresentou catálogo, porém não corresponde aos itens.	Excellence	aberto
1	37-47-48	Aprovado	Priorittá	Aprovado
1	45,137,141,142	Aprovado	Fusao	Aprovado
1	58,59	Aprovado	Emige	Aprovado
1	143	Aprovado	Emige	Aprovado
1-2	63 e 154	Aprovado	Altermed	Aprovado
1	64,65,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,136,138,139,140,144	Aprovado	Juliano	Aprovado
1	82,83,84	Conforme apresentação de catálogo indica padrão ISO, porém este padrão indica determinado	Mastermedic	aberto

		diâmetro/comprimento. Não indica as demais especificações: austenítico din 1.4310, eletropolida, pertencente a classificação aisi 302, aproximadamente 17% de cromo e 8% níquel, confeccionada por torção, estéril, solicitar esclarecimento		
2	153	Aprovado	Mastermedic	Aprovado
1	130,131,132,133,134, 135	Aprovado	Agua boa	Aprovado
2	151	Reprovado - iluminação interna natural, não atendendo a especificação.	Primemed	Reprovado
2	151	Aprovado	V. I. fuzeti	Aprovado

Ubiratã, 18 de novembro de 2022


Camila Aparecida Carvalho da Silva


Kerstyeen Ragna Meyer


Helder Borges Fernando Júnior

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 | Fone (44) 3543-
8000

www.ubirata.pr.gov.br



PARECER DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

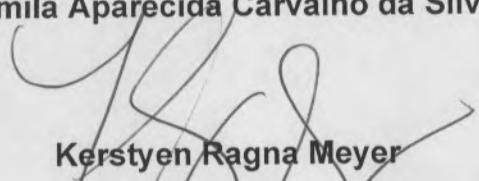
PREGÃO 173/2022

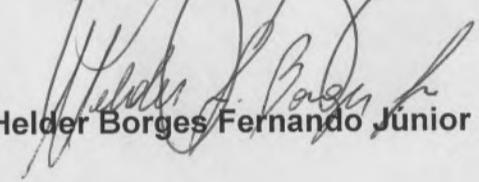
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote	Item	Resultado	Fornecedor	Avaliação
1	1,66	Conforme esclarecimento via chat, produtos aprovados.	Suprema dental	aprovado
1	146,149	Conforme esclarecimento via chat, produtos aprovados.	Suprema dental	aprovado
1	145	aprovado	excellence	aprovado
1	37	aprovado	Emige	aprovado
1	48	aprovado	Suprema dental	aprovado

Ubiratã, 18 de novembro de 2022


Camila Aparecida Carvalho da Silva


Kerstyeen Ragna Meyer


Helder Borges Fernando Junior

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 | Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br

UBIRATÃ



PARECER DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

PREGÃO 173/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, DE INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Empresa: EXCELLENCE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS

Itens reprovados - não foi possível analisar mesmo após documentação complementar.

Item 67: Lima endodôntica tipo flexofile 1ª série 21 mm		
Comprimento	21 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	15-40	OK
Secção transversal	Triangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 68: Lima endodôntica tipo flexofile 1ª série 25 mm		
Comprimento	25 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	15-40	OK
Secção transversal	Triangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 69: Lima endodôntica tipo flexofile 1ª série 31 mm		
Comprimento	31 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	15-40	OK
Secção transversal	Triangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 70: Lima endodôntica tipo flexofile # 15 21 mm		
Comprimento	21 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	15	OK
Secção transversal	Triangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 71: Lima endodôntica tipo flexofile # 15 25 mm		
Comprimento	25 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	15	OK
Secção transversal	Triangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 72: Lima endodôntica tipo flexofile # 15 31 mm		
Comprimento	31 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	15	OK
Secção transversal	Triangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 73: Lima endodôntica tipo flexofile # 20 21 mm		
Comprimento	21 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	20	OK
Secção transversal	Triangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 74: Lima endodôntica tipo flexofile # 20 25 mm		
Comprimento	25 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	20	OK
Secção transversal	Triangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 75: Lima endodôntica tipo flexofile # 20 31 mm		
Comprimento	31 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	20	OK
Secção transversal	Triangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 76: Lima endodôntica tipo k 1º série 21 mm		
Comprimento	21 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	15-40	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 77: Lima endodôntica tipo k 1º série 25 mm		
Comprimento	25 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	15-40	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 78: Lima endodôntica tipo k 1º série 31 mm		
Comprimento	31 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	15-40	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 79: Lima endodôntica tipo k 2º série 21 mm		
Comprimento	21 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	45-80	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado
Classificação		Não especificado /descritivo AISI 302
Composição		Não especificado /descritivo 17% cromo 8% níquel
Composição cabo		Não especificado/ descritivo plástico tipo poliamida

Item 80: Lima endodôntica tipo k 2º série 25 mm		
Comprimento	25 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	45-80	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado
Classificação		Não especificado /descritivo AISI 302
Composição		Não especificado /descritivo 17% cromo 8% níquel
Composição cabo		Não especificado/ descritivo plástico tipo poliamida

Item 81: Lima endodôntica tipo k 2º série 31 mm		
Comprimento	31 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	45-80	Não confere com o descritivo (06-80) descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado
Classificação		Não especificado /descritivo AISI 302
Composição		Não especificado /descritivo 17% cromo 8% níquel
Composição cabo		Não especificado/ descritivo plástico tipo poliamida

Item 85: Lima endodôntica tipo k #06 21 mm		
Comprimento	21 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	06	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 86: Lima endodôntica tipo k #06 25 mm		
Comprimento	25 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	06	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 87: Lima endodôntica tipo k #06 31 mm		
Comprimento	31 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	06	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 88: Lima endodôntica tipo k #08 21 mm		
Comprimento	21 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	08	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 89: Lima endodôntica tipo k #08 25 mm		
Comprimento	25 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	08	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 90: Lima endodôntica tipo k #08 31 mm		
Comprimento	31 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	08	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 91: Lima endodôntica tipo k #10 21 mm		
Comprimento	21 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	10	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 92: Lima endodôntica tipo k #10 25 mm		
Comprimento	25 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	10	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 93: Lima endodôntica tipo k #10 31 mm		
Comprimento	31 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	10	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 94: Lima endodôntica tipo k #15 21 mm		
Comprimento	21 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	15	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 95: Lima endodôntica tipo k #15 25 mm		
Comprimento	25 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	15	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 96: Lima endodôntica tipo k #15 31 mm		
Comprimento	31 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	15	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 97: Lima endodôntica tipo k #20 21 mm		
Comprimento	21 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	20	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 98: Lima endodôntica tipo k #20 25 mm		
Comprimento	25 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	20	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 99: Lima endodôntica tipo k #20 31 mm		
Comprimento	31 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	20	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 06-140
Secção transversal	Quadrangular	OK
Conexidade (Taper)		Não especificado
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Item 100: Lima endodôntica tipo Hedstroem 1ª série 21 mm		
Comprimento	21 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	15-40	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 08-140
Secção transversal	Circular	Não confere com o descritivo (circular)/descritivo em forma de gota
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado

Classificação		Não especificado /descritivo AISI 302
Composição		Não especificado /descritivo 17% cromo 8% níquel

Item 101: Lima endodôntica tipo Hedstroem 1ª série 25 mm		
Comprimento	25 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	15-45	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 08-140
Secção transversal	Circular	Não confere com o descritivo (circular)/ descritivo em forma de gota
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado
Classificação		Não especificado /descritivo AISI 302
Composição		Não especificado /descritivo 17% cromo 8% níquel

Item 102: Lima endodôntica tipo Hedstroem 1ª série 31 mm		
Comprimento	31 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	15-45	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 08-140
Secção transversal	Circular	Não confere com o descritivo (circular)/ descritivo em forma de gota
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado
Classificação		Não especificado /descritivo AISI 302
Composição		Não especificado /descritivo 17% cromo 8% níquel

Item 103: Lima endodôntica tipo Hedstroem 2ª série 21 mm		
Comprimento	21 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	45-80	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 08-140
Secção transversal	Circular	Não confere com o descritivo (circular)/ descritivo em forma de gota

Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado
Classificação		Não especificado /descritivo AISI 302
Composição		Não especificado /descritivo 17% cromo 8% níquel

Item 104: Lima endodôntica tipo Hedstroem 2ª série 25 mm

Comprimento	25 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	45-80	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 08-140
Secção transversal	Circular	Não confere com o descritivo (circular)/ descritivo em forma de gota
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado
Classificação		Não especificado /descritivo AISI 302
Composição		Não especificado /descritivo 17% cromo 8% níquel

Item 105: Lima endodôntica tipo Hedstroem 2ª série 31 mm

Comprimento	21 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	45-80	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 08-140
Secção transversal	Circular	Não confere com o descritivo (circular)/ descritivo em forma de gota
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado
Classificação		Não especificado /descritivo AISI 302
Composição		Não especificado /descritivo 17% cromo 8% níquel

Item 106: Lima endodôntica tipo Hedstroem #15 21 mm

Comprimento	21 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	#15	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 08-140
Secção transversal	Circular	Não confere com o

		descritivo (circular)/ descritivo em forma de gota
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado
Classificação		Não especificado /descritivo AISI 302
Composição		Não especificado /descritivo 17% cromo 8% níquel

Item 107: Lima endodôntica tipo Hedstroem #15 25 mm

Comprimento	25 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	#15	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 08-140
Secção transversal	Circular	Não confere com o descritivo (circular)/ descritivo em forma de gota
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado
Classificação		Não especificado /descritivo AISI 302
Composição		Não especificado /descritivo 17% cromo 8% níquel

Item 108: Lima endodôntica tipo Hedstroem #15 31 mm

Comprimento	31 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	#15	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 08-140
Secção transversal	Circular	Não confere com o descritivo (circular)/ descritivo em forma de gota
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado
Classificação		Não especificado /descritivo AISI 302
Composição		Não especificado /descritivo 17% cromo 8% níquel

Item 109: Lima endodôntica tipo Hedstroem #20 21 mm


Comprimento	21 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	#20	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo

		08-140
Secção transversal	Circular	Não confere com o descritivo (circular)/ descritivo em forma de gota
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado
Classificação		Não especificado /descritivo AISI 302
Composição		Não especificado /descritivo 17% cromo 8% níquel

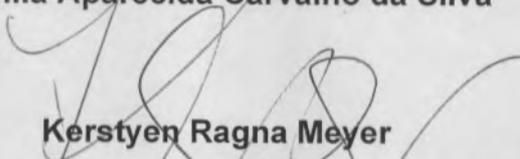
Item 110: Lima endodôntica tipo Hedstroem #20 25 mm		
Comprimento	25 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	#20	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 08-140
Secção transversal	Circular	Não confere com o descritivo (circular)/ descritivo em forma de gota
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado
Classificação		Não especificado /descritivo AISI 302
Composição		Não especificado /descritivo 17% cromo 8% níquel

Item 111: Lima endodôntica tipo Hedstroem #20 31 mm		
Comprimento	31 mm	OK
Material	Aço inoxidável	OK
Tamanho #	#20	Não confere com o descritivo (06-80)/descritivo 08-140
Secção transversal	Circular	Não confere com o descritivo (circular)/ descritivo em forma de gota
Stops de silicone		Não especificado
Estéril		Não especificado
Classificação		Não especificado /descritivo AISI 302
Composição		Não especificado /descritivo 17% cromo 8% níquel

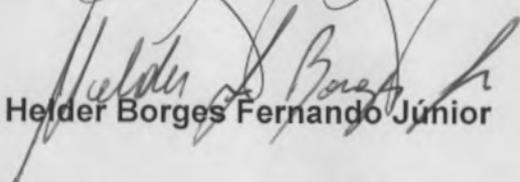
Ubiratã, 22 de novembro de 2022



Camila Aparecida Carvalho da Silva



Kerstyeen Ragna Meyer



Helder Borges Fernando Júnior

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino -
1852 CEP 85.440-000 |
Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br