





PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE IMBITUVA
ESTADO DO PARANÁ

ANALISE DE AMOSTRAS – PREGÃO 106/2022

LOTE	ITEM	EMPRESA	RESULTADO
001	001	ALTEVIR AUGUSTO	APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
002	001	ALTEVIR AUGUSTO	APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
003	001	CE CARVALHO	APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
004	001	ALTEVIR AUGUSTO	APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
005	001	CE CARVALHO	APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
006	001	ALTEVIR AUGUSTO	APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
007	001	V.G.ROCHA COMERCIO	REPROVADO NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
008	001	1º COLOCADO EQUIMED EQUIPAMENTOS 2º COLOCADO CE CARVALHO	REPROVADO NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
009	001	CE CARVALHO	APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
010	001	FBF FORNECEDORA	APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL


Gesiely Schneider Borges

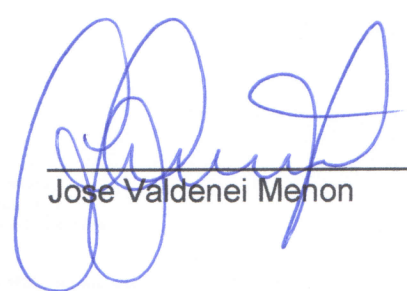
Jose Valdenei Menon

Ibituva, 29 de novembro de 2022.

Cardioversor com DEA e Marcapasso – Lote 7

Fabricante: Nihon Kohden

Modelo: TEC 5631

Registro ANVISA: 80914690011

Após análise ao manual do produto registrado na ANVISA sob o número 80914690011 verifica-se que:

Edital solicita: TELA EM LCD OU LED, NO MÍNIMO 7 (SETE) POLEGADAS:

15. Recursos técnicos

Indicações

Indicações na tela

Monitor:	Diagonal de 6,5 pol., TFT-LCD colorido
Tela de exibição:	132,48 mm × 99,36 mm
Número de pixels:	640 (A) × 480 (V)

Indicações do formato de onda

Número de formatos de onda

Apenas ECG: 1 traço de formato de onda de ECG ou 2 traços de cascata de ECG¹

Na medição de SpO₂: Formato de onda da pulsação¹

Formato de onda na medição de CO₂:
Formato de onda da respiração¹


¹ Seleccionável pela configuração

O manual do equipamento Nihon Kohden modelo TEC 5631 na página 15-4 informa que a tela é do tipo TFT-LCD de 6,5 polegadas não atendendo ao edital.

Edital solicita: IMPRESSÃO AUTOMÁTICA/ MANUAL DO TIPO CABEÇA TÉRMICA, LARGURA MÍNIMA DO PAPEL 80MM

2. Descrição do painel

Lado direito do painel



1 Slot do cartão SD

Insira um cartão de memória SD.

2 Alavanca de liberação da porta

Puxe a alavanca para cima para abrir a porta do recipiente de papel.

3 Gravador

Esse é um gravador de matriz térmica de 50 mm de largura.

Abasteca com o papel de gravação (RQS50-3) especificado pela Nihon Kohden.

O manual do equipamento Nihon Kohden modelo TEC 5631 na página 2-6 informa que o gravador é de matriz térmica de 50 mm e suporta papel de 50 mm e não atende ao edital.

Edital solicita: BIFÁSICO, COM CARGA MÁXIMA REGULÁVEL DE NO MÍNIMO DE 300 JOULES

Energia de saída

Energia de saída (com carga de 50 Ω):

2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 ou 270 J

Limite superior da energia de carga

Pás externas: 270 J

Patches descartáveis: 270 J

Pás internas: 50 J

Pás internas (com interruptor):
50 J

Modo DEA:

1º: 50 J, 2º: 200 J, 3º: 200 J (configurações padrão)

(As configurações padrão podem ser selecionadas entre 50, 70, 100, 150, 200 e 270 J.)

Modo DEA (modo infantil): 1º: 50 J, 2º: 70 J, 3º: 70 J (configurações padrão)

(As configurações padrão podem ser selecionadas entre 50, 70 e 100 J.)

O manual do equipamento Nihon Kohden modelo TEC 5631 na página 15-12 informa que a energia máxima de saída é 270J e não atende ao edital.

Monitor Multiparâmetros – Lote 8

Fabricante: CONTEC

Modelo: CMS 9000

Registro ANVISA: 81449010002

Após análise ao manual do produto registrado na ANVISA sob o número 81449010002 verifica-se que:

Edital Solicita: Monitor multiparâmetros com tecnologia mista pré-configurado ECG, Oximetria SpO2, PNI (Pressão não invasiva), temperatura - 2 canais, respiração, pressão invasiva – 2 canais e capnografia com tecnologia sidestream com possibilidade futura para instalação de módulos de Pressão Invasiva - 2 canais - possibilitando monitorar 4 (quatro) canais de pressão invasiva ao mesmo tempo / BIS - Índice de sedação anestésica / Débito Cardíaco / A.G. Agentes Anestésicos sem a necessidade de incluir software, hardware, cabos de interligação / conexão e licenças.

Conforme verificado na proposta encaminhado pela empresa CE Carvalho o Monitor da marca Contec modelo CMS9000 não tem tecnologia mista (pré-configurado e possibilidade futura para demais parâmetros através de módulos) conforme solicita o edital dessa forma o equipamento não atende aos requisitos do certame.

Edital Solicita: visualização da Δ PP / PPV e SPV (Variação de Pressão Sistólica)

Conforme verificado na proposta encaminhado pela empresa CE Carvalho o Monitor da marca Contec modelo CMS9000 não possui o parâmetro Δ PP / PPV e SPV (Variação de Pressão Sistólica) conforme solicita o edital dessa forma o equipamento não atende aos requisitos do certame.

Monitor Multiparâmetros – Lote 8

Fabricante: Creative

Modelo: K12

Registro ANVISA: 80901110026

Após análise ao manual do produto registrado na ANVISA sob o número 80901110026 verifica-se que:

Edital Solicita: O equipamento ofertado deverá utilizar uma das seguintes tecnologias de medição de oximetria: Masimo SET, Nellcor oximax, Mindray, Nihon Koden, Fast SpO2 (Philips) ou Comen.

Conforme verificado na proposta encaminhado pela empresa o Monitor da marca CREATIVE modelo K12 não foi especificado a tecnologia da oximetria ofertada, o edital e claro - deverá utilizar uma das seguintes tecnologias de medição. Dessa forma a proposta não atende ao edital.

Edital Solicita: visualização do SPV (Variação de Pressão Sistólica)

Conforme verificado na proposta encaminhado pela empresa o Monitor da marca CREATIVE modelo K12 não possui o parametro SPV (Variação de Pressão Sistólica conforme solicita o edital dessa forma o equipamento não atende aos requisitos do certame.